

Số: 168/BVYDCT-TTBVTYT

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty cung cấp trang thiết bị y tế.

Bệnh viện Y dược cổ truyền Ninh Thuận có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023. Để có cơ sở lập dự toán mua sắm, Bệnh viện đề nghị quý Công ty tham gia cung cấp báo giá theo danh mục cấu hình và thông số kỹ thuật thiết bị y tế của đơn vị, cụ thể: theo danh mục đính kèm thư mời này.

Quý Công ty có quan tâm vui lòng gửi báo giá về Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận:

- **Thời gian:** trong giờ hành chính từ 7 giờ 30 ngày 22 tháng 03 năm 2023 đến trước 9 giờ ngày 02 tháng 4 năm 2023.


- Báo giá nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận, **địa chỉ:** 05 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 02593.820668.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Công ty, trân trọng./.

(Đính kèm danh mục cấu hình, thông số kỹ thuật thiết bị y tế)

Nơi nhận: *lah*

- Như trên;
- Trung tâm KSBT (đăng Website Sở Y tế);
- Ban GD BV;
- Lưu: VT, TTBVTYT.

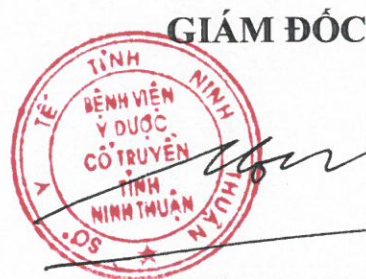

Ngô Văn Hợp




**DANH MỤC CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TẮM NHẬN ẢNH X QUANG KỸ THUẬT SỐ KHÔNG DÂY**

Kèm theo Công văn số 1608/BVYDCT-TTBVTYT, ngày 22/03/2023 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Ninh Thuận)

STT	Tên thiết bị	Cấu hình, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Tấm nhận ảnh X quang kỹ thuật số không dây	<p>Tấm nhận ảnh x quang kỹ thuật số (loại không dây)</p> <ul style="list-style-type: none">- Năm sản xuất: năm 2023- Thiết bị mới 100% chưa sử dụng- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO 13485- Phân loại theo TT14: nhóm 3 <p>Cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tấm nhận ảnh DR (không dây): 02 tấm- Phần mềm xử lý ảnh: 01 bộ- Bộ linh kiện kèm theo: 01 bộ- Bộ máy tính kèm theo (Core i5 trở lên hoặc tương đương, RAM \geq 4GB, Ổ cứng HDD \geq 1TB, màn hình \geq 19 inch): 01 bộ- Máy in phim khô Laser: 01 bộ <p>Tính năng kỹ thuật:</p> <p>1. Tấm nhận ảnh DR</p> <ul style="list-style-type: none">- Công nghệ nhận ảnh: Silicon không định hình hoặc tương đương- Chất phát quang nhấp nháy: CsI hoặc tương đương- Vùng hoạt động: \geq 17x17 inches- Ma trận điểm ảnh: \geq 4267 \times 4267pixels- Kích thước điểm ảnh: \leq 100 μm- Độ phân giải: \geq 4.3lp/mm- Chuyển đổi AD: \geq 16 bit- Chế độ phát hiện: AED (lựa chọn)/ phần mềm- Thời gian hình ảnh đầy đủ: \leq 3s- Trọng lượng: \leq 03kg- Tải trọng tối đa trên bề mặt (tải tĩnh): \geq 300kg <p>2. Phần mềm xử lý ảnh:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tự động thu thập thông tin bệnh nhân và ảnh	Bộ	1

STT	Tên thiết bị	Cấu hình, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<p>khi chụp thông qua DICOM Worklist.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truy vấn tự động tìm kiếm trên máy chủ Worklist ở mọi khoảng thời gian chỉ định, tạo điều kiện để xử lý các ca chụp một cách nhanh chóng và hiệu quả. - Hiện thị hình ảnh thu được trong một khoảng thời gian rất ngắn sau khi chụp. - Thông số xử lý, ROI, Marker, LUT, v.v. theo các bộ phận cơ thể khác nhau - Hỗ trợ DICOM 3.0 và truyền hình ảnh tới máy chủ PACS, các công việc in ấn và Worklist <p>3. Máy in phim khô Laser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương thức in: Laser - Số khay phim: 02 khay - Có thể in các cỡ phim: 20x25, 25x30, 26x36, 35x43 cm - Kích thước điểm ảnh: 50 μm (508 dpi)/ 100 μm (254 dpi) - Mức thang xám: 14 bit - Bộ nhớ hình ảnh: 1 GB - Điều chỉnh mật độ: Tự động 		



lah